




Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás

Coordenação de VIGIPÓS

Informe Técnico de Hemovigilância nº 030, março de 2017

Neste informe técnico continuaremos a tratar sobre a Retrovigilância. Desta vez divulgamos o fluxograma de ação a partir da confirmação do resultado inicial positivo ou inconclusivo da sorologia do doador.

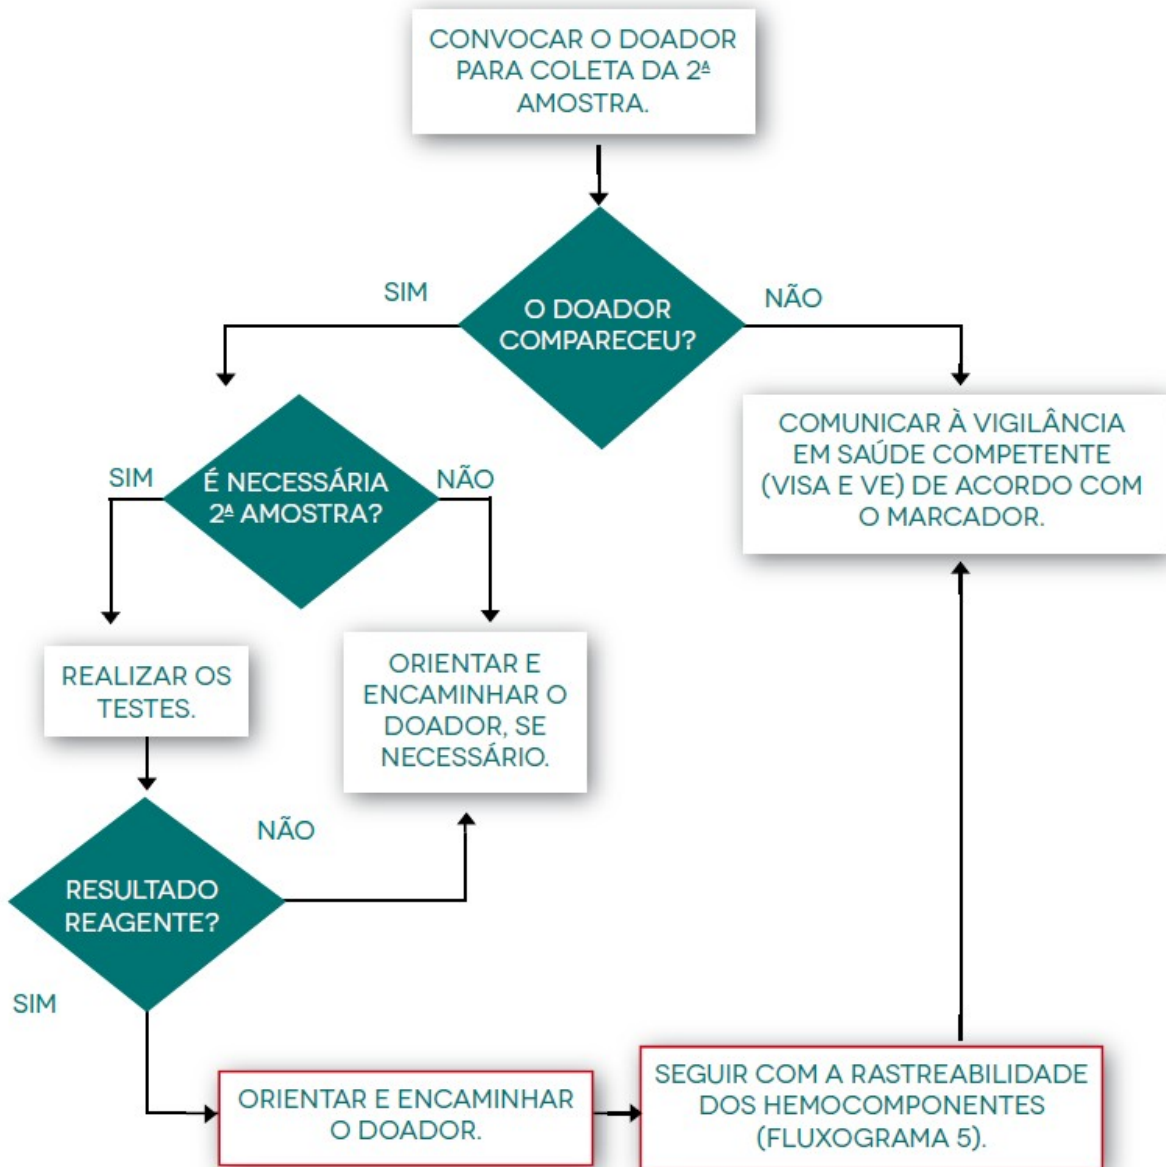

Este fluxograma e outros estão no Marco Conceitual e Operacional de Hemovigilância: Guia para a Hemovigilância no Brasil, disponível em <http://portal.anvisa.gov.br/hemovigilancia>

Canal aberto para contato: (62) 3201-3541

hemovigilancia@saude.go.gov.br



Coordenação de VIGIPÓS – HEMOVIGILÂNCIA

Este informe técnico mensal será distribuído exclusivamente por meio eletrônico