


FLUXO PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA

ANTIVARICELA-ZOSTER

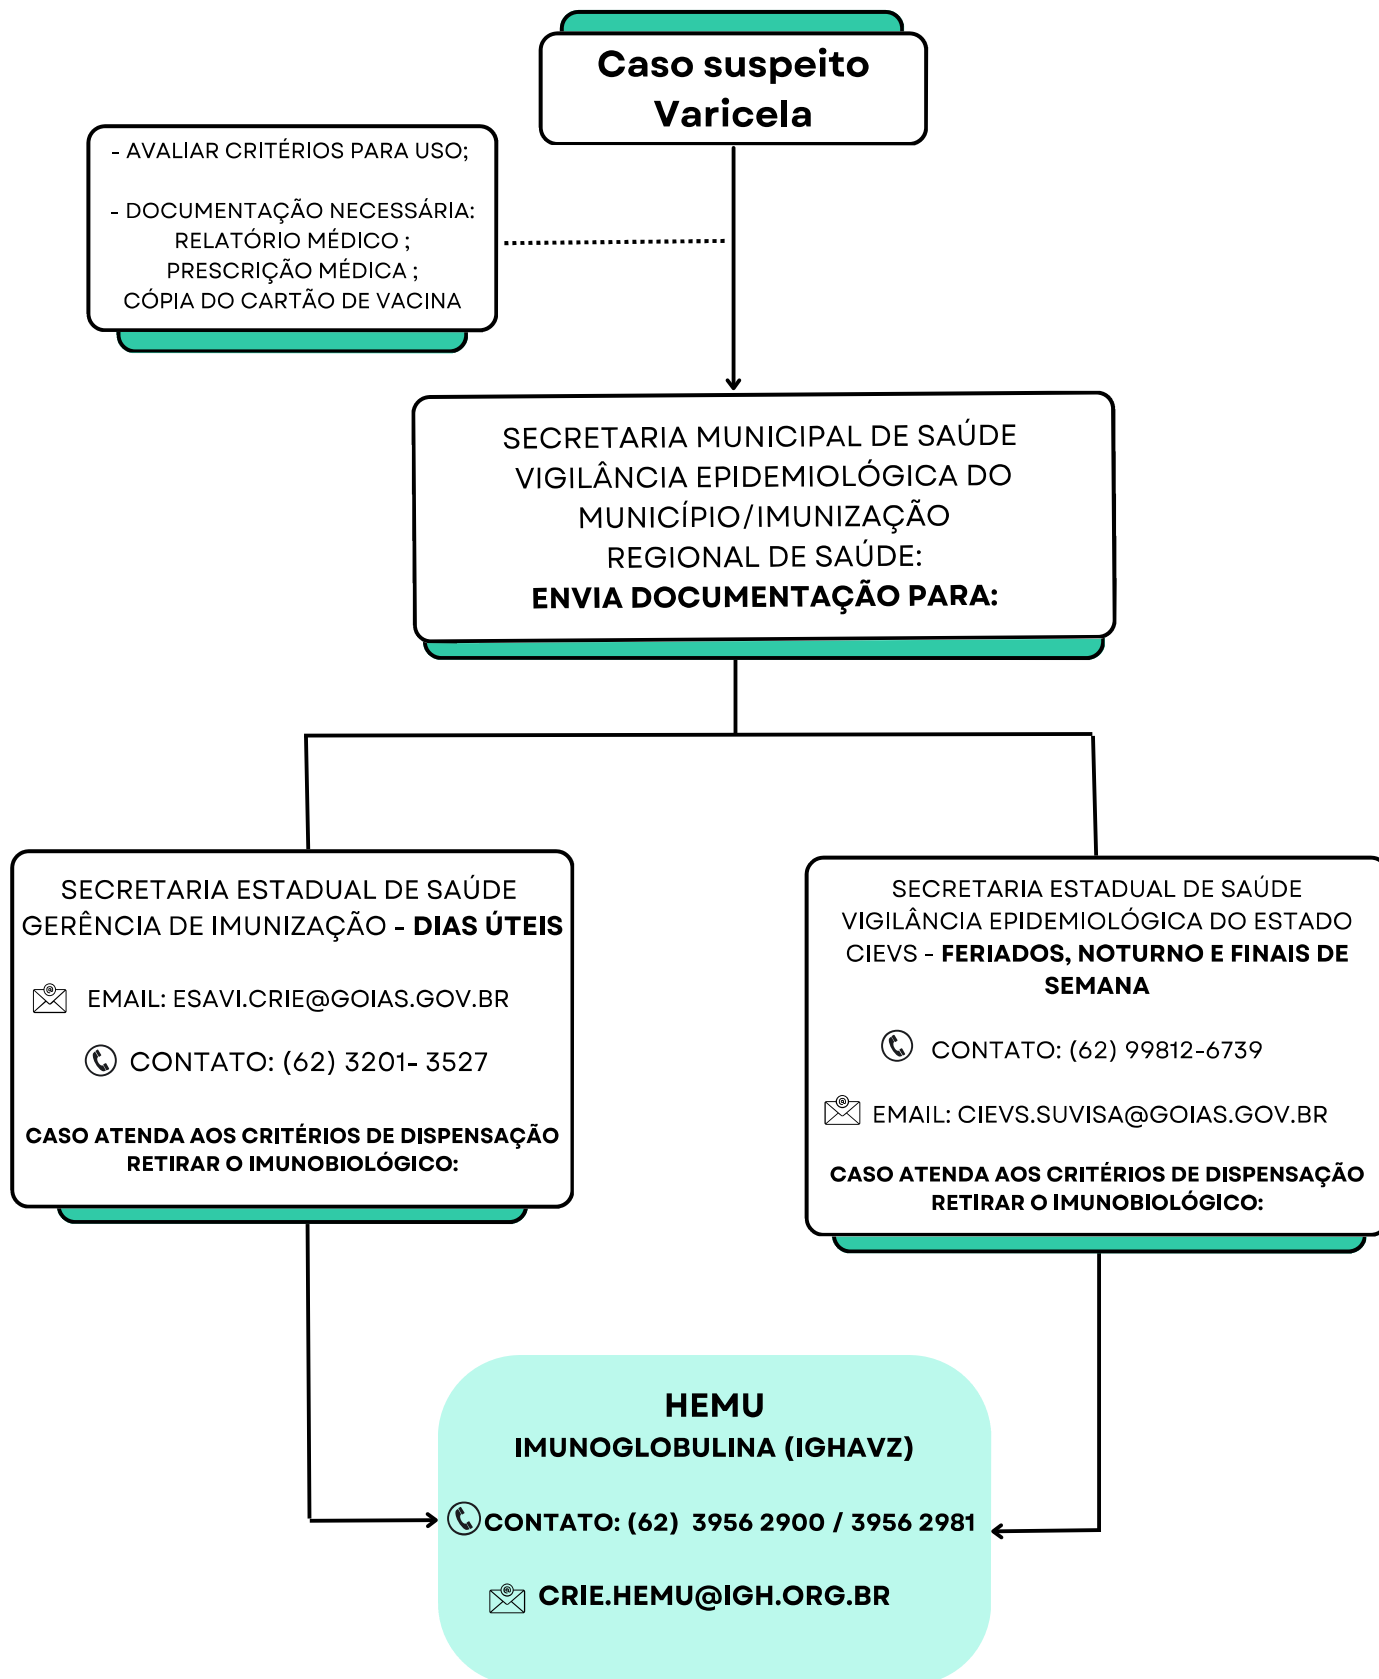

OBS: PARA RETIRADA DA IMUNOGLOBULINA, O PROFISSIONAL DEVE ESTAR MUNIDO DE CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO, BOBINAS REUTILIZÁVEIS O SUFICIENTE PARA MANTER A TEMPERATURA INTERNA DA MESMA ENTRE +2°C A + 8°C E TERMÔMETRO DE CABO EXTENSOR OU DATALOGGER